

1 Installez le Pilote USB et le Logiciel Track-It™

IMPORTANT ! Ne branchez PAS l'Enregistreur Track-It™ dans le port USB avant d'avoir installé les Pilotes USB et le Logiciel Track-It™.


Téléchargez le Logiciel d'Enregistrement des Données Track-It™ à l'adresse suivante:

http://www.monarchinstrument.com/Software/Track-It_Software.zip

Décompressez le fichier téléchargé dans un répertoire local sur votre PC.

Double-cliquez sur "CD_Start.exe". Le menu Track-It™ apparaît comme indiqué ci-contre.

1. Cliquez "Installer le Pilote USB" et suivez les instructions. Cliquez "Continuer" si vous voyez un message d'installation de logiciel.
2. Cliquez "Installer le Logiciel" et suivez les instructions pour compléter l'installation. Le Logiciel est maintenant installé et prêt à être utilisé.
3. Les manuels de l'enregistreur et du logiciel sont accessibles ici.

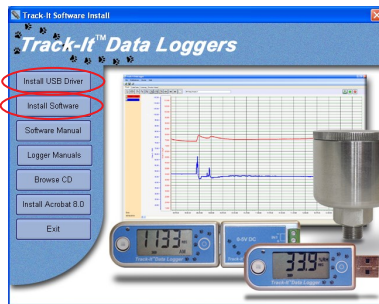

2 Installez la batterie de l'enregistreur (si requis)

Installez la batterie fournie avec votre enregistreur Track-It™. Référez-vous au diagramme ci-dessous pour l'installation. **Certains modèles auront une batterie préinstallée.**

Retirez le capuchon à l'extrémité avec une pièce et insérez la batterie comme suit :




Temp robuste
3.6V 1/2AA Lithium
Haute Température

Retirez le capuchon et insérez la batterie comme suit :



Pressure/Temp
3.6V 1/2AA

Les batteries de type "Clé USB" sont préinstallées




Temp, RHTemp, DC I/V, AC Evènement, Baro/Temp
3V CR2032 ronde
Ou 3.6V EF651625 (LTC-7PN)

3 Connectez l'enregistreur et exécutez Track-It™


Branchez l'enregistreur Track-It™ dans un port USB du PC. Certains modèles se branchent directement sur le port USB. D'autres se connectent au port USB avec un câble (fourni). Si l'Assistant d'Installation d'un Nouveau Programme apparaît, suivez les instructions pour terminer l'installation.

Démarrez le Logiciel Track-It™ en double-cliquant sur l'icône Track-It (affiché ci-contre) sur votre PC ou à partir du menu de démarrage.

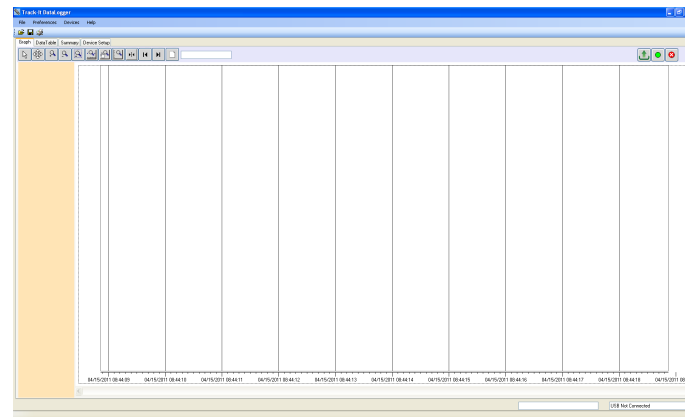

4 Connectez votre Enregistreur

Si les Pilotes USB ont été bien installés, vous verrez « appareil connecté » en bas à droite de la fenêtre du logiciel Track-It™.




Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le Logiciel Track-It™ pour configurer votre enregistreur et/ou pour visualiser des données enregistrées.

Le Logiciel Track-It™ listera les appareils Track-It™ connectés à votre PC. Pour voir la liste et pour passer d'un appareil à un autre, cliquez sur Appareil et ensuite sur Liste des Appareils.



5 Configuration et début d'enregistrement

Sélectionnez l'onglet « Configuration de l'Appareil » comme indiqué. Le logiciel récupérera et affichera automatiquement la configuration de l'enregistreur.

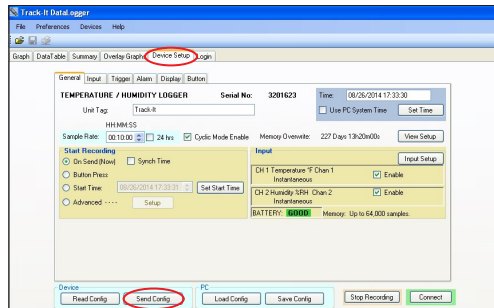

Vérifiez la configuration d'usine et effectuez les modifications nécessaires : rythme d'échantillonnage, déclencheurs, alarmes, etc. Vérifiez que la date et l'heure soient correctement renseignées. Cliquez sur le bouton « Envoyer la Configuration » sous la section « Configuration de l'Appareil » de la fenêtre. **Votre Enregistreur est maintenant opérationnel !**



15 Columbia Drive
Amherst, NH 03031 USA

Ph: 603-883-3390
www.monarchinstrument.com

Rev.1.7

Track-It™ Data Loggers



**Guide de Prise en
Main Rapide**

Para español, vea el manual al descargar.
Deutsch siehe Handbuch beim Download.
Pour le français, voir le manuel en téléchargement.
Per l'italiano, consultare il manuale al momento
del download.